



CPF :023.151.861-70	Paciente :Carlton Celio do Carmo Nascimento	RG :/
CNPJ :24.176.011/0001-95	Razão :TC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Nascimento :14/10/1986	Idade : 39 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :SERVENTE	
Data do Exame : 01/04/2026		

Orelha Direita

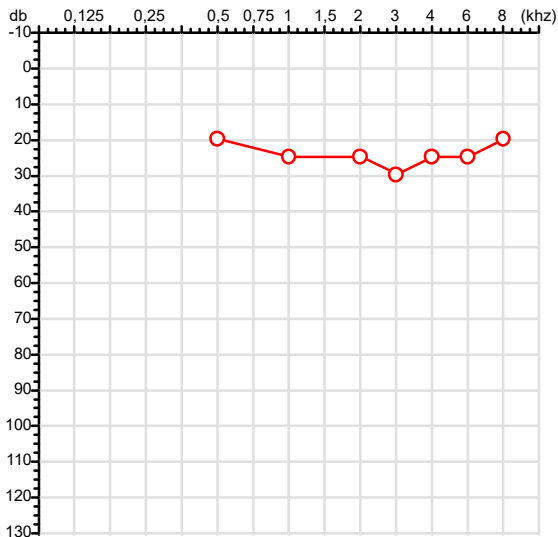

Audiometria

Orelha Esquerda

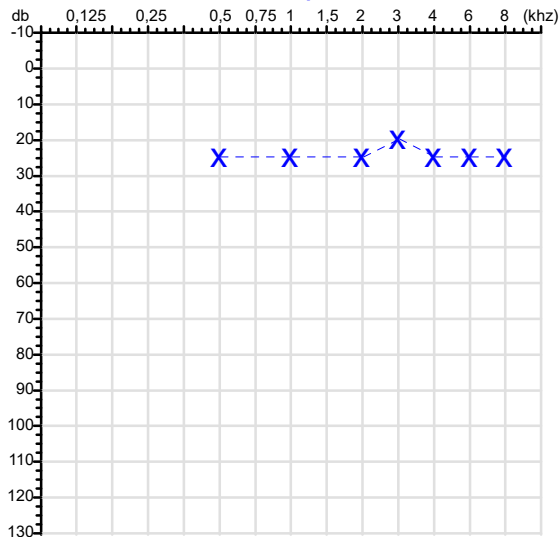

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	30	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	30	25	25	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :F03751A45D782FCE436024B613CE4579
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlton Celio do Carmo Nascimento
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2025