



CPF :071.792.871-30	Paciente :Gabriel Mycaio Gomes Martins	RG :2826900-4/SESP MT
CNPJ :05.419.995/0001-43	Razão :JR MOVEIS LTDA	
Nascimento :06/01/2001	Idade : 25 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :MAQUINISTA	
Data do Exame : 01/04/2026		

Orelha Direita

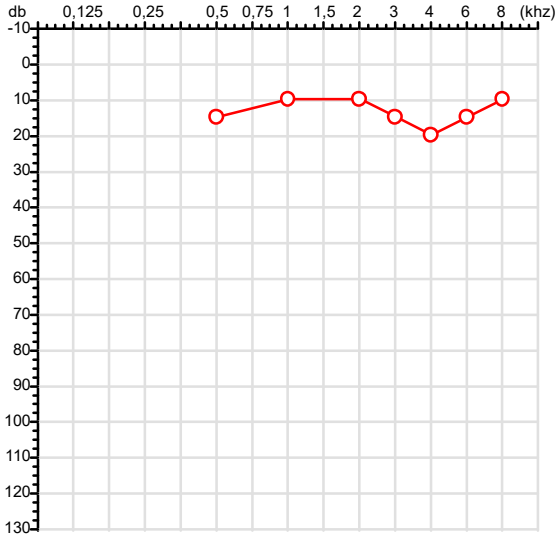

Audiometria

Orelha Esquerda

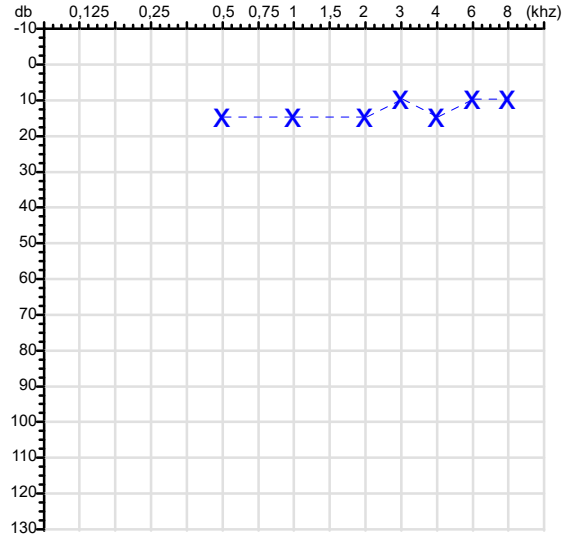

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	20	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	10	15	10	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	20	15	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	10	15	10	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :12431DF010FB6D22A94529821CECFEB9
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gabriel Mycaio Gomes Martins
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025