



CPF :635.484.452-68 Paciente :Mauro Roberto Silva de Souza RG :/
 CNPJ :02.922.621/0001-58 Razão :AP SOLDA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
 Nascimento :14/09/1977 Idade : 48 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
 Data do Exame : 13/04/2026

Orelha Direita

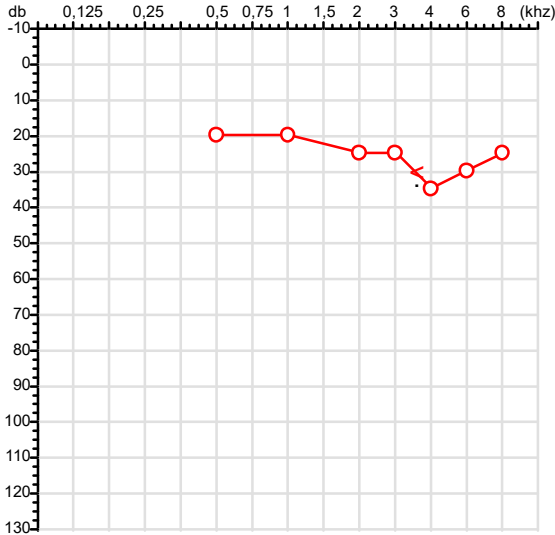

Audiometria

Orelha Esquerda

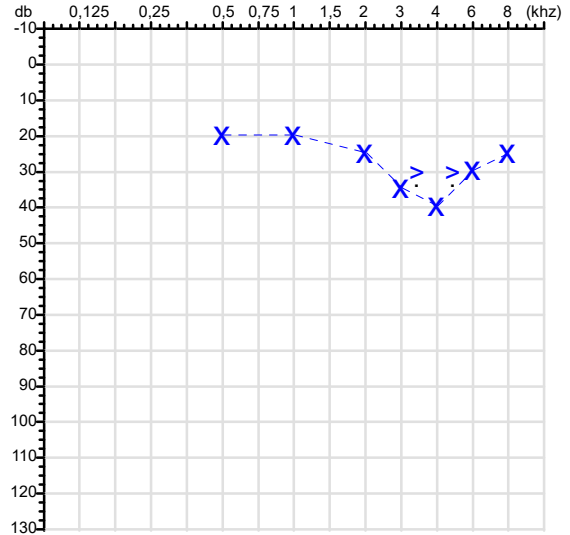

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	35	30	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	30	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	35	30	30

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	30	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :084D205A26C3816E4E8760123C45E10E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mauro Roberto Silva de Souza
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025