
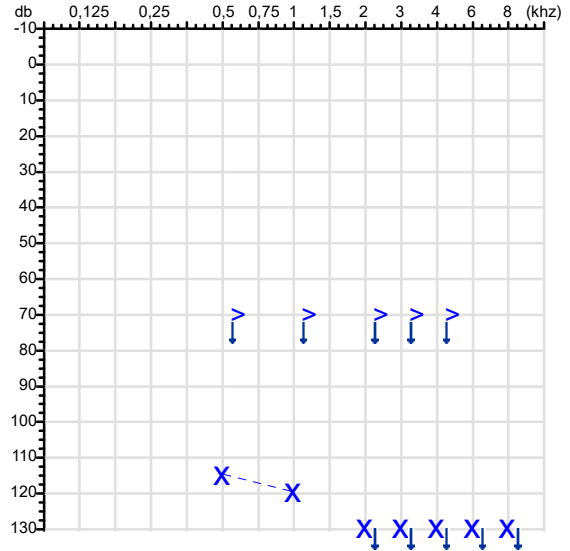


CPF :044.221.871-04 Paciente :Guilhermme de Amorim Silva RG :24792799/SSP MT  
 Nascimento :21/11/2007 Idade : 18 anos  
 Motivo :Complementar Setor :  
 Repouso :14h Função :...  
 Data do Exame : 30/04/2026

**Orelha Direita**

Audiometria

**Orelha Esquerda**

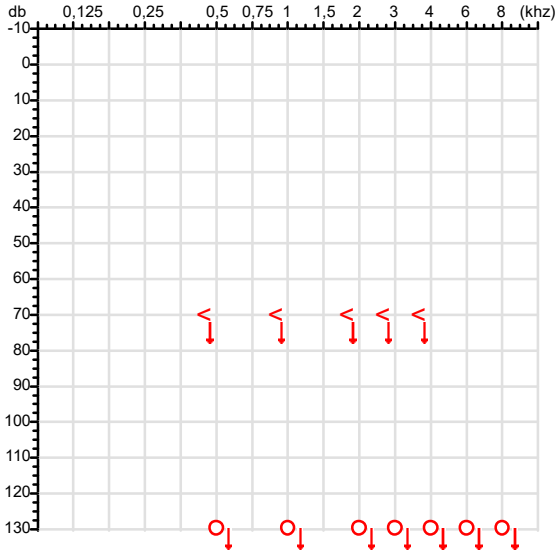

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	115	120	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	AUS	AUS	AUS	130	AUS	AUS	AUS	130

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	115	120	AUS	122	AUS	AUS	AUS	130

**Laudo Clínico OD**

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

**Laudo Clínico OE**

Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :D59D4D84798D5053FB9049AAD5BBEC6C  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Guilhermme de Amorim Silva*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025