


Exame n.º :823951


CPF :967.851.441-91 Paciente :Paulo Evaristo de Campos RG :1443352-4/SESP MT
 CNPJ :32.951.535/0079-02 Razão :ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
 Nascimento :23/12/1981 Idade : 44 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Ceter :DEPOSITO
 Repouso :14h Função :MOTORISTA ENTREGADOR III
 Data do Exame : 26/05/2026

Orelha Direita

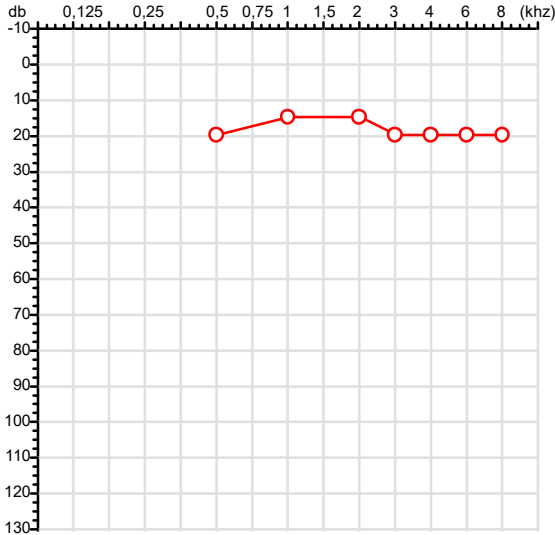

Audiometria

Orelha Esquerda

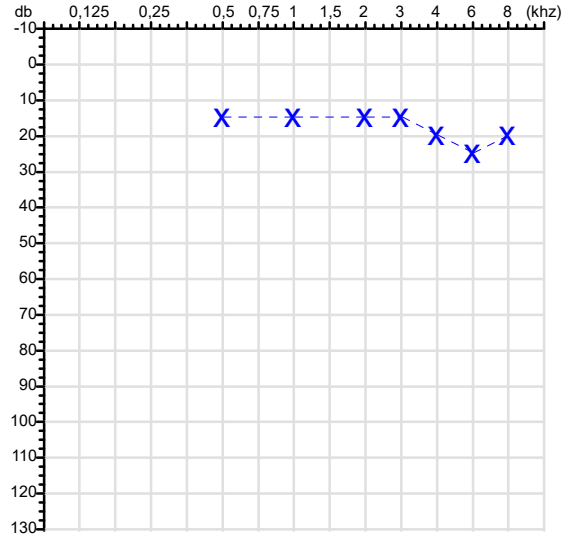

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	20	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
 Médica
 CRM-MT 13330
 NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :4C20502E17C1C4F4D741B9316F01EA5A
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Evaristo de Campos
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025