



CPF :697.591.032-49	Paciente :Adelino de Oliveira Almeida	RG :/
CNPJ :36.920.895/0001-20	Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA	
Nascimento :01/06/1973	Idade : 53 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OBRA / CONSTRUCAO	
Reposou :14h	Função :PEDREIRO	
Data do Exame : 10/06/2026		

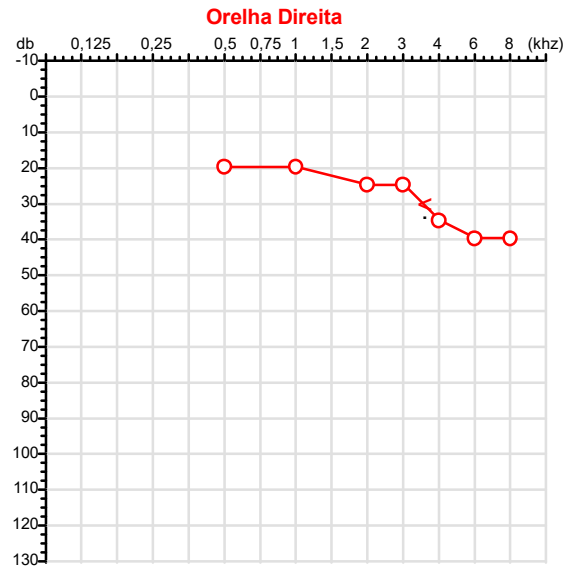

Audiometria

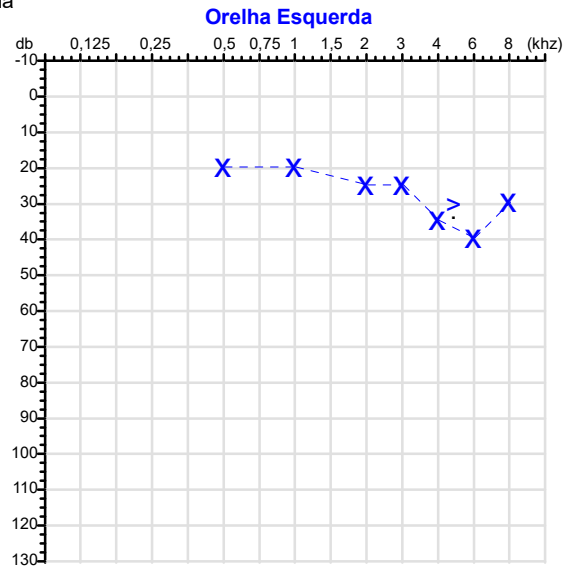

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	35	40	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	40	30

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	35	40	33

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	40	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :280CC45DB929A63032772D3F01709425
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adelino de Oliveira Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025