
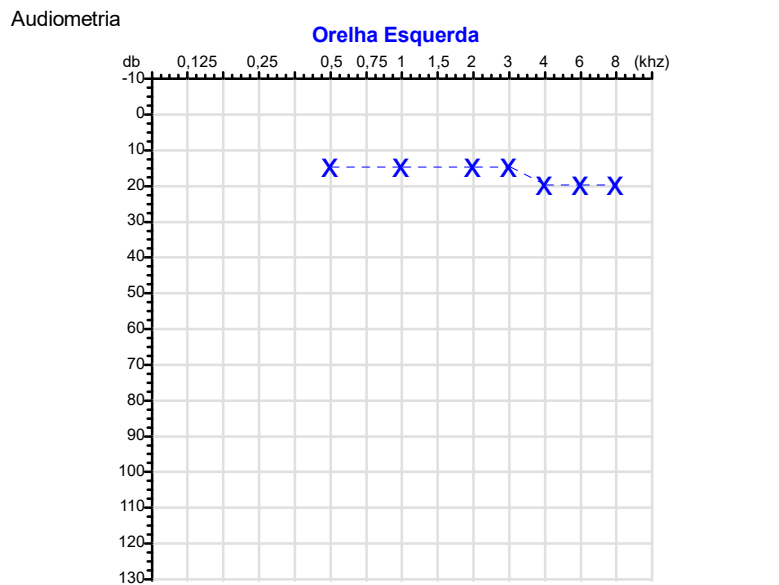


CPF :037.306.001-76	Paciente :Tiago Prado Reis	RG :19539851/SSP/MT
CNPJ :12.027.138/0001-63	Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	
Nascimento :12/05/1991	Idade : 35 anos	
Motivo :Periódico	Setor :CONSTRUCAO CIVIL - CORTE E DOBRA 6 MTS	
Reposuo :14h	Função :SUPERVISOR (A) DE PRODUCAO SENIOR	
Data do Exame : 11/06/2026		

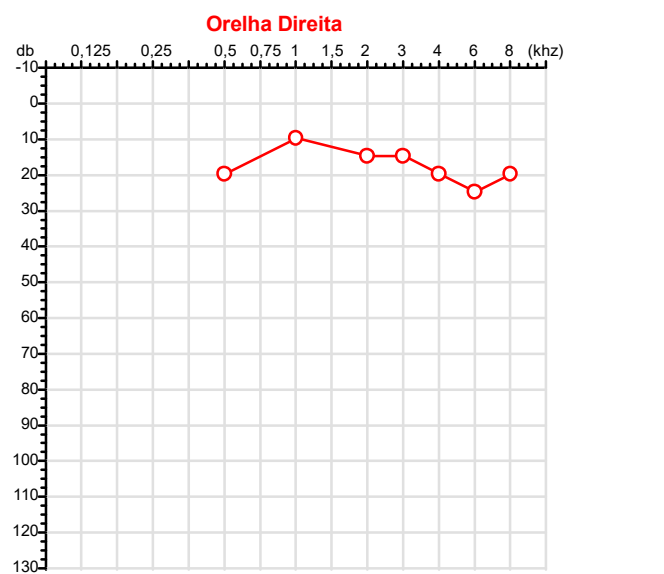

**Aérea**

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	20	20

**Ossea**

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	20	18

**Lauda Clínico OD**  
 Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :3F73A84ED44411B25FBA78521743B844  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Tiago Prado Reis*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025