
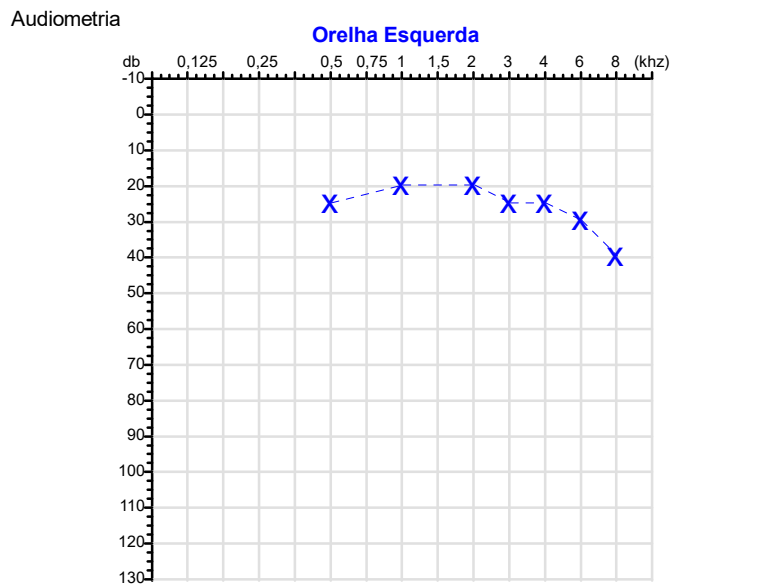


CPF :874.098.601-20	Paciente :Varlei Jose Pereira	RG :08803056/SSP MT
CNPJ :04.716.683/0001-39	Razão :C A DO NASCIMENTO ME	
Nascimento :14/09/1976	Idade : 49 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 15/06/2026		

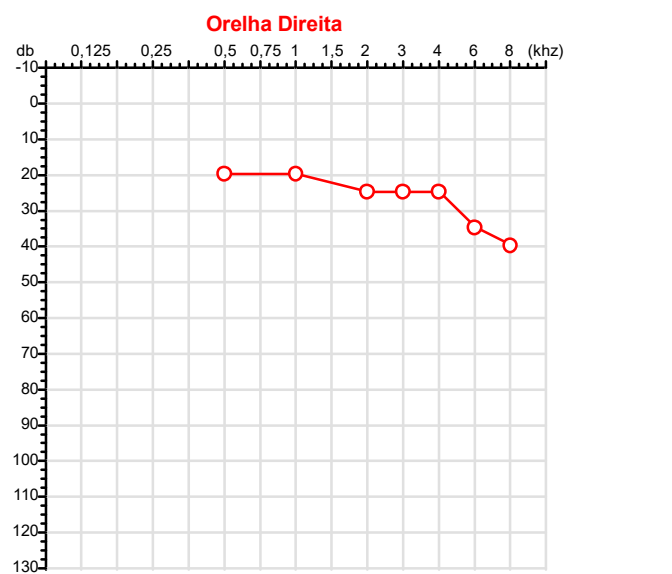

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	25	35	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	30	40

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	25	35	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	30	27

**Laudo Clínico OD**  
 Alteração auditiva com configuração descendente leve

**Laudo Clínico OE**  
 Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :957BB42992388FE35F1E9E1A0455D36A  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Varlei Jose Pereira*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025