



CPF :041.506.611-54 Paciente :Marilza Mikaelly Silva Novaes RG :/  
 CNPJ :44.404.676/0001-16 Razão :RH ASSESSORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA  
 Nascimento :01/09/1998 Idade : 27 anos  
 Motivo :Admissional Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :OPERADORA DE TELEMARKETING  
 Data do Exame : 15/06/2026

Audiometria

Orelha Direita

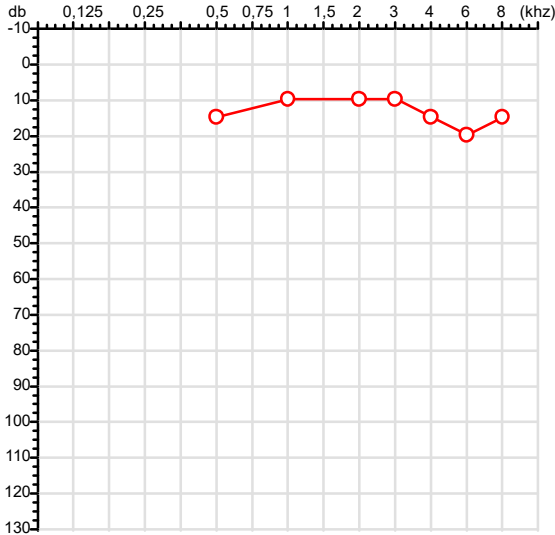

Orelha Esquerda

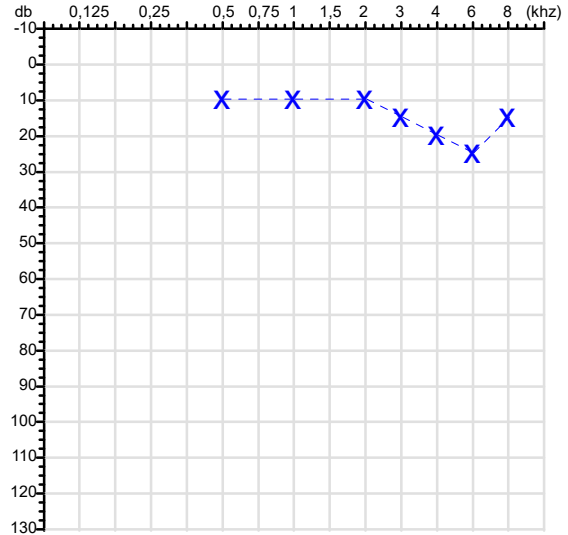

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	20	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	20	25	20

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :F988B051BFA082235007A1D7C0A08258  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Marilza Mikaelly Silva Novaes*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025