



CPF :041.647.711-94	Paciente :Guilherme Martins Neiva de Souza	RG :/
CNPJ :55.624.454/0001-25	Razão :PORTO POWERSPORTS LTDA	
Nascimento :24/12/2007	Idade : 18 anos	
Motivo :Admissional	Setor :COMERCIAL	
Reposuo :14h	Função :ENTREGADOR	
Data do Exame : 19/06/2026		

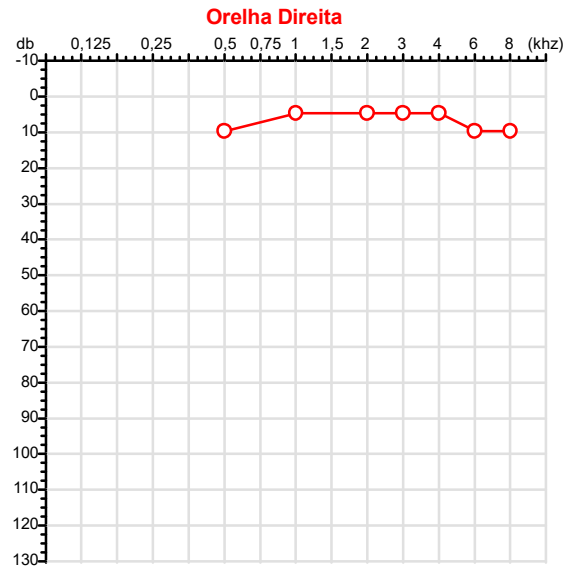

Audiometria

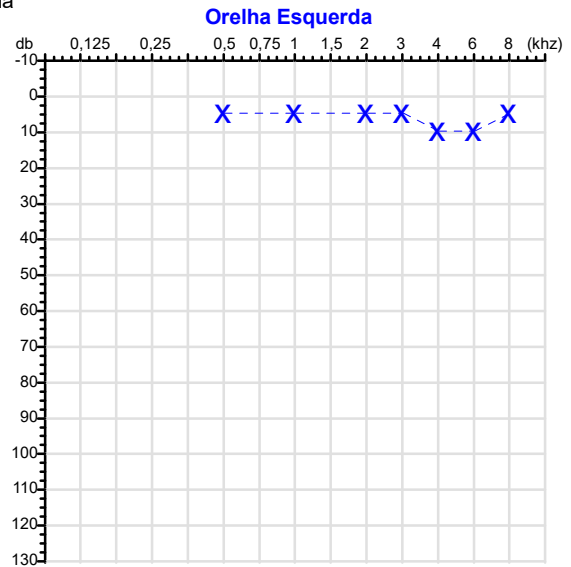

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	5	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	5	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	5	10	7

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C1F1134289668D136ECD9F1A42295B7C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Guilherme Martins Neiva de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025