
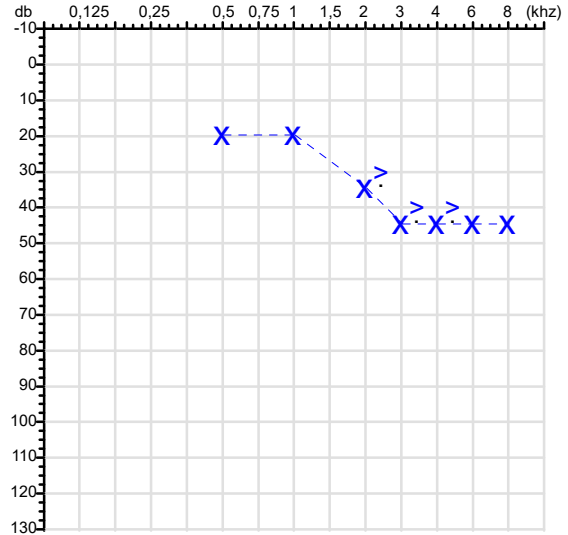


CPF :729.883.042-20	Paciente :Rosivaldo Castro Ribeiro	RG :/
CNPJ :03.819.157/0011-03	Razão :ATRATIVA ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :20/06/1976	Idade : 50 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE MAQUINA ESTACA RAIZ	
Data do Exame : 25/06/2026		

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

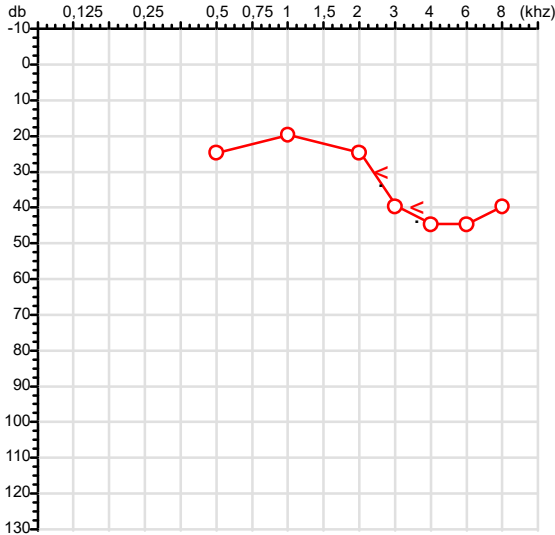

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	40	45	45	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	45	45	45	45

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	40	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	40	45	45	43

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	45	45	45	45

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6D496D3631B8501AF8D9151CDE4A0751

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rosivaldo Castro Ribeiro

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025