


Exame n.º :830819

CPF :705.417.472-07
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :22/07/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2026

Paciente :Eliton de Almeida Pereira
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :34528946/SSP AM

Orelha Direita

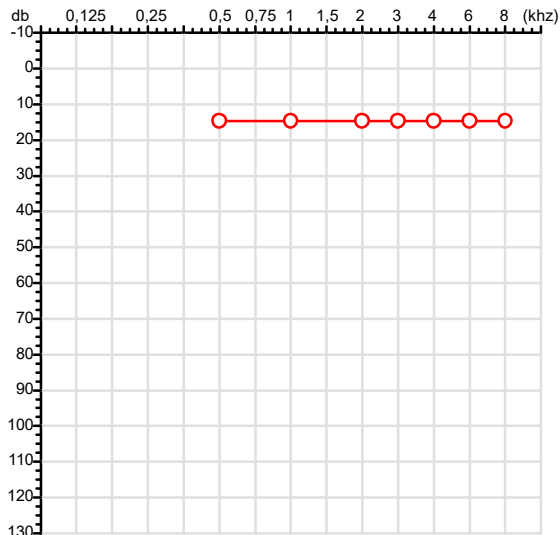

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :4A87ACF78079A3594EC117EFB9CB50E7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Eliton de Almeida Pereira


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

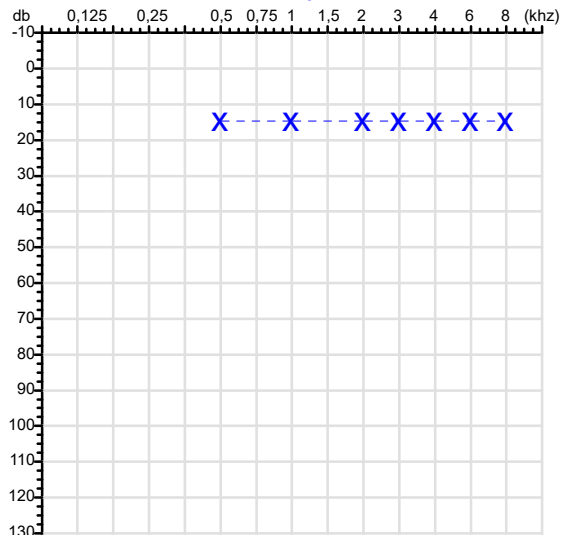

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 26/06/2026
Primeiro Nome: ELITON DE ALMEIDA
Sobrenome: PEREIRA
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 80.0

Data de nascimento: 22/07/1998
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 26/06/2026 14:56

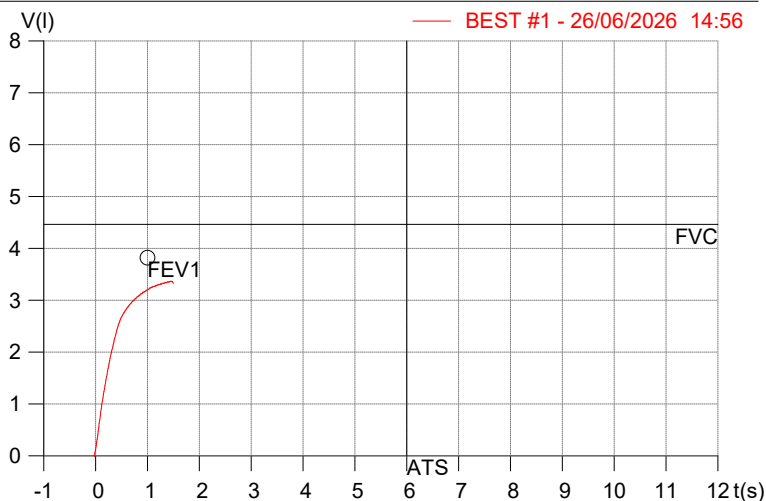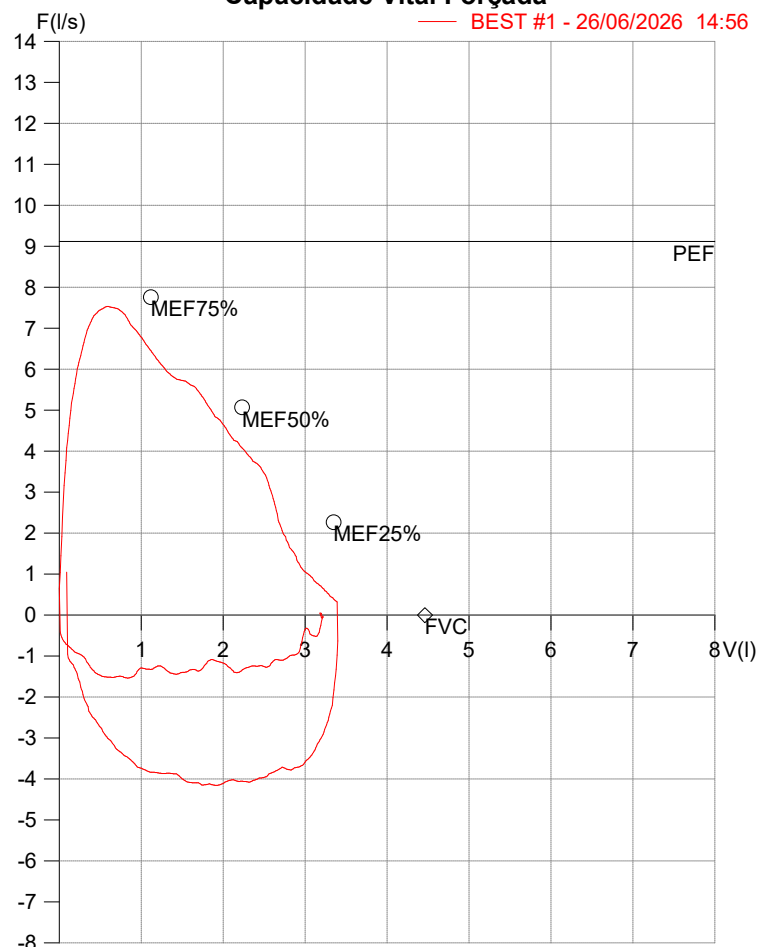

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.46	3.41	76.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.46	3.41	76.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.82	3.24	84.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.12	7.54	82.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.16	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.3	95.0	115.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.74	5.03	106.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.76	7.09	91.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.07	5.43	107.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.26	3.24	142.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	547.2	452.1	82.6

Diagnóstico:

Espirometria normal