



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01303940000112 Fantasia : SELCO ENGENHARIA LTDA
Razão Social : SELCO ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA BEIRA RIO N.º 1655 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

Funcionário

Nome : Kaick Bruno de Jesus Valadares Setor: ENGENHARIA ELETRICA
CPF : 07205823188 Cargo: TECNICO ELETROTECNICO
RG : 26883473 / MT Nascimento: 08/02/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura : ACF2A7088CC27B5BFEFB2AF980EB9349
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :830913

CPF :072.058.231-88 Paciente :Kaick Bruno de Jesus Valadares
CNPJ :01.303.940/0001-12 Razão :SELCO ENGENHARIA LTDA
Nascimento :08/02/2001 Idade : 25 anos
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Ocupação : ENGENHARIA ELETRICA
Repouso :14h Função :TECNICO ELETROTECNICO
Data do Exame : 29/06/2026

RG :26883473/MT

Audiometria

Orelha Direita

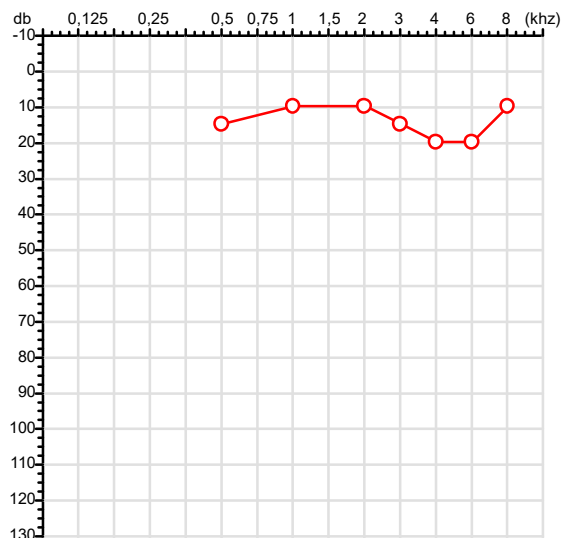

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	20	20	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

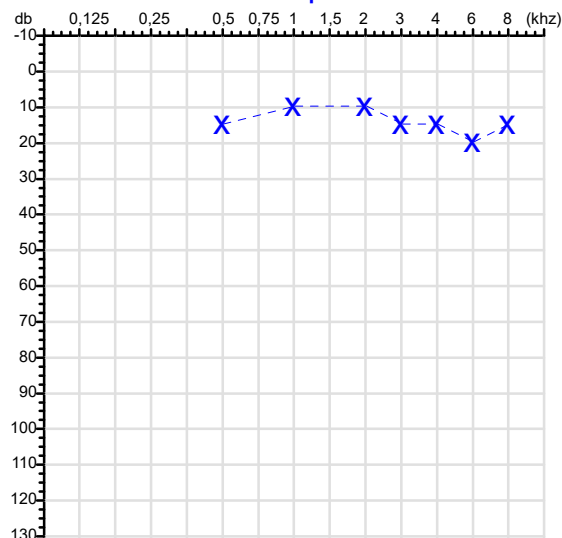

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8402A6637577DA999024857C69B869E8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kaick Bruno de Jesus Valadares

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	KAICK BRUNO DE JESUS VALADARES		ID1	830913	Sexo	Masculino	Idade	25,3	Peso (kg)	74,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	08/02/2001	--	BMI (kg/m2)	27,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
07:23	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,08	4,25	96	
FEV1	L	3,95	3,64	109	
FEV1/FVC%	%	96,9	86,0	113	
FEV1/Vcmax%	%	96,9	86,0	113	

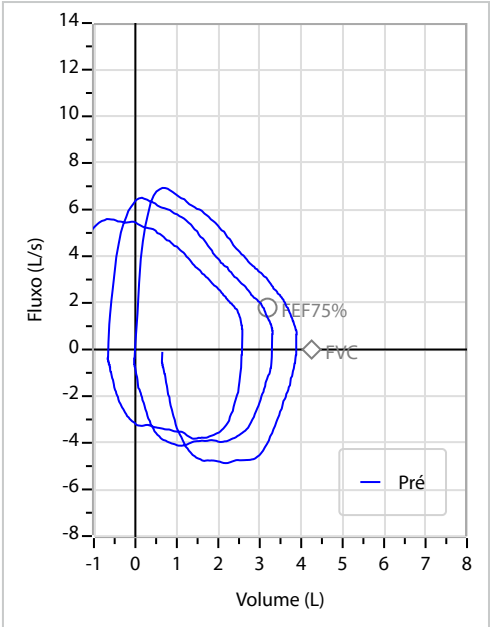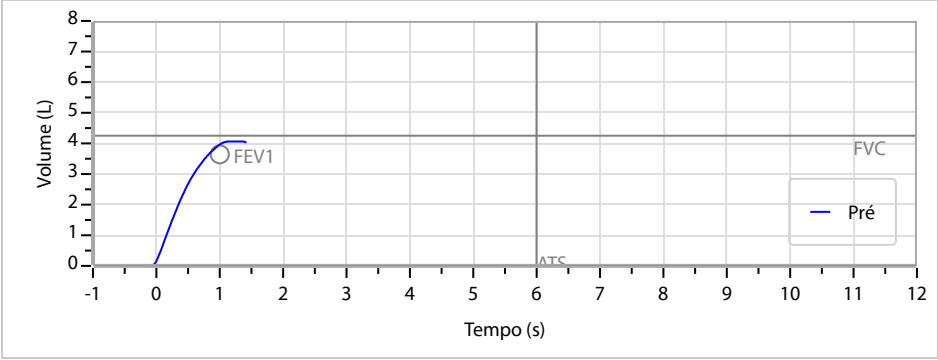

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,9% e um valor FVC de 4,08 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo:2606290830029

Data:29/06/2026

Paciente:KAICK BRUNO DE JESUS VALADARES


Nasc.:08/02/2001 RG :26883473-MT

CPF:07205823188

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS. MATERIAL DE OSTEOSSÍNTESE COMPOSTO POR PLACA E PARAFUSOS METÁLICOS NA CLAVÍCULA ESQUERDA.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

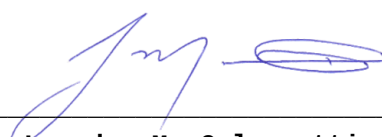

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=616444634826177440361367393579>

