


Exame n.º :831372

CPF :058.476.061-25
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :16/05/1990
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 30/06/2026

Paciente :Jiumar Benedito de Jesus
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 36 anos
Setor :TRANSPORTE
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita

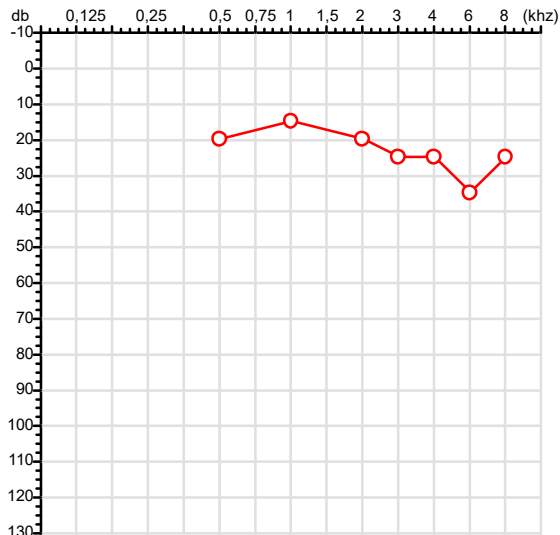

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	35	28


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

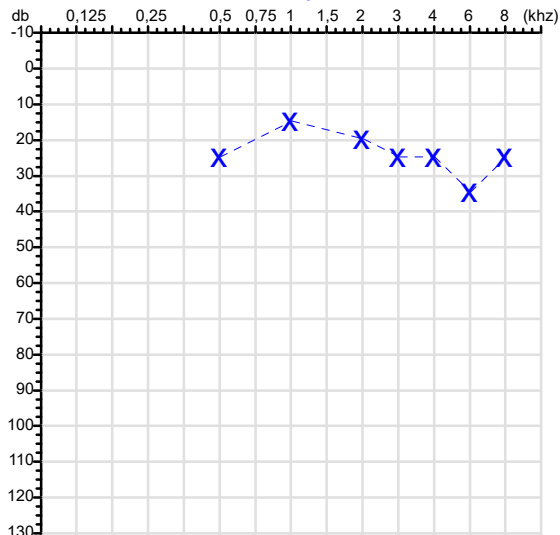

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	20	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6B055677CB99D5D7290CF8C8FA284827

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jiumar Benedito de Jesus

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 831372
Primeiro Nome: Jiumar Benedito d
Sobrenome: JESUS
Data: 30/06/2026

Data de nascimento: 16/05/1990
Sexo : Macho
Peso (kg): 130.0
Altura (cm): 170.0

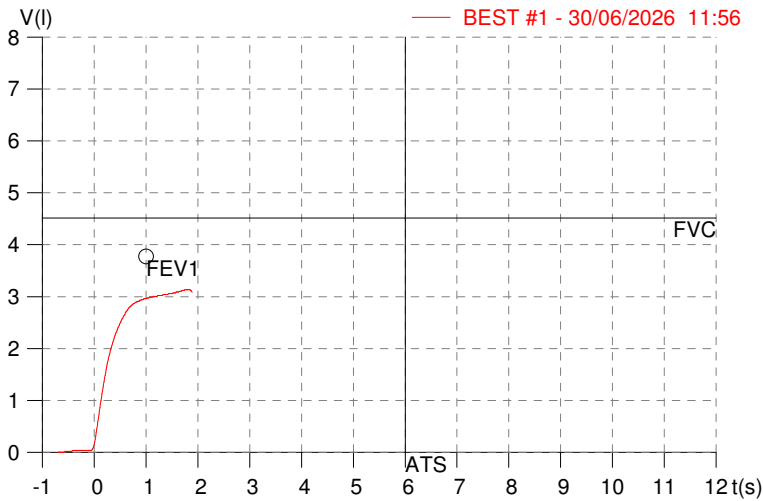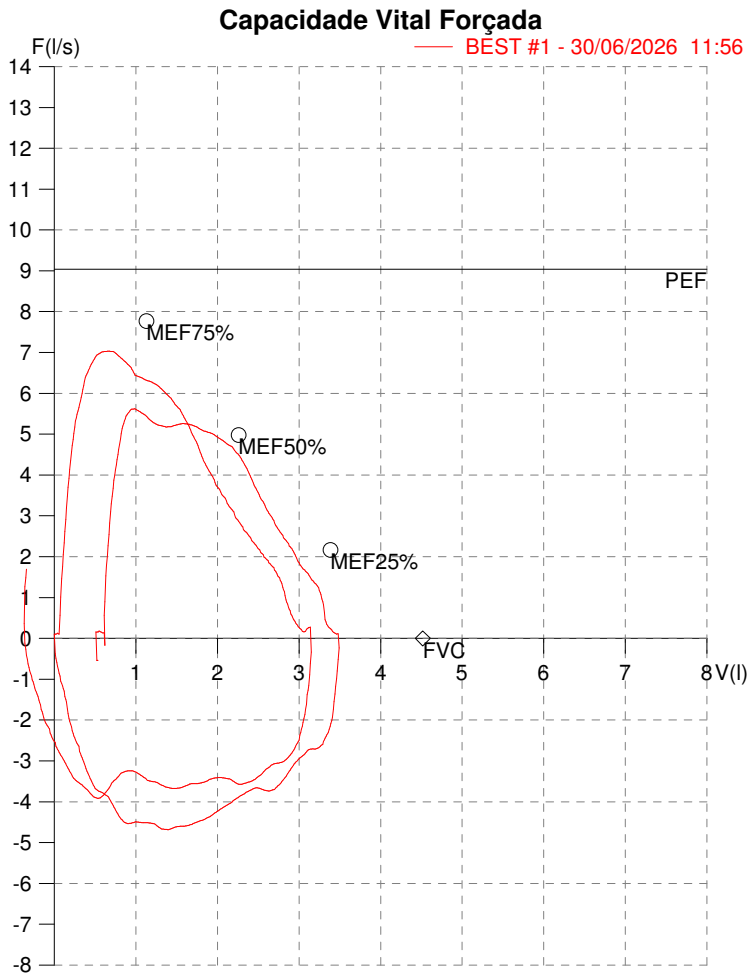

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.52	3.16	69.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.52	3.16	69.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.78	2.98	78.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.04	7.03	77.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.92	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.7	94.4	116.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.45	4.59	103.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.77	6.90	88.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.98	5.42	108.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.16	2.53	117.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	542.4	422.0	77.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 30/06/2026