



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Vanderlan Carvalho de Souza Setor: FORCA - MONTAGEM ELETRICA - FORCA
CPF : 06102698525 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 17/10/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :EE33BF4B67C690955EA12C9B1118867B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :835420


CPF :061.026.985-25
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :17/10/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2026

Paciente :VANDERLAN CARVALHO DE SOUZA
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 32 anos
Setor :FORCA - MONTAGEM ELETRICA - FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

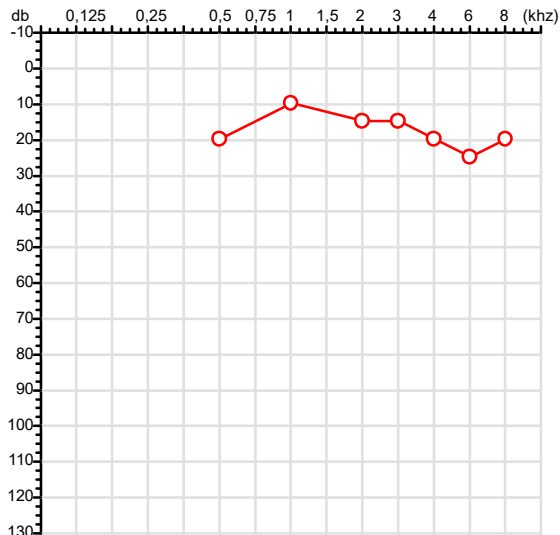

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

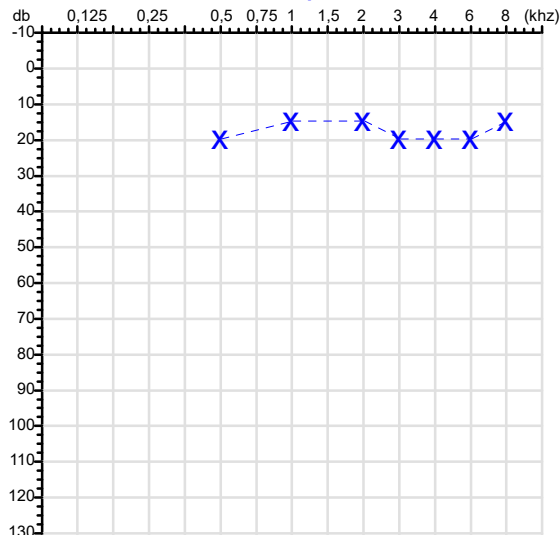

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BF04AC56DA3A3054AEF0A2712ADFEF7A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vanderlan Carvalho de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	VANDERLAN CARVALHO DE SOUZA			ID1	836520	Sexo	Masculino	Idade	32,7	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/10/1993	ID2	--	BMI (kg/m2)	23,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico				Classe 2	--	Etnia Outros/Não Especificado					

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

07:41



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,04	4,46	68		
FEV1	L	2,68	3,73	72		
FEV1/FVC%	%	88,1	83,7	105		
FEV1/Vcmax%	%	88,1	83,7	105		

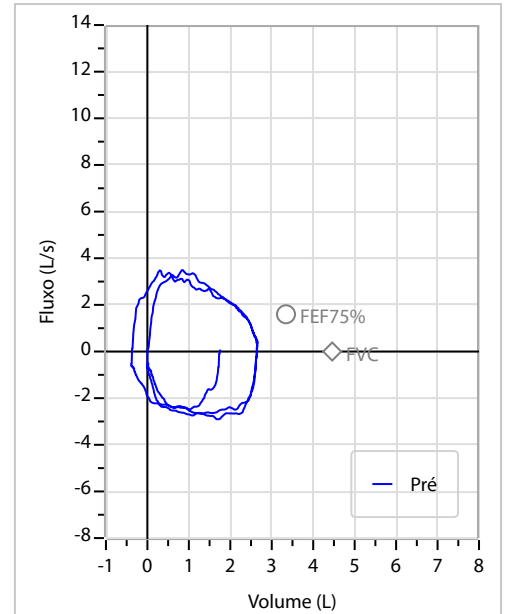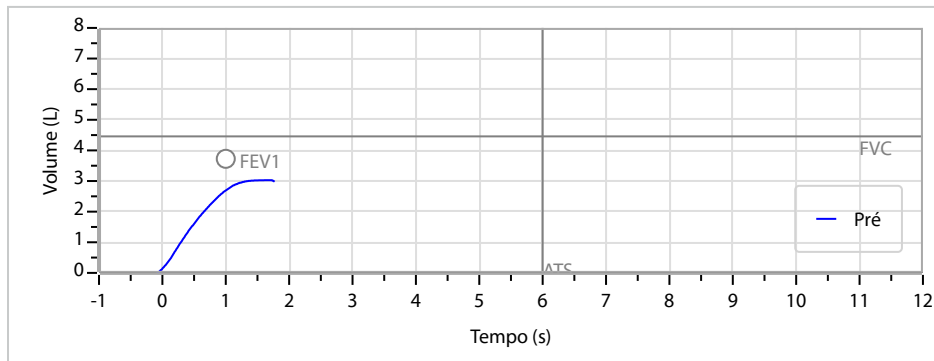

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,04 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo :2607210849589

Data:21/07/2026

Paciente:VANDERLAN CARVALHO DE SOUZA

Nasc.:17/10/1993 RG :-

CPF:06102698525

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=721887119635734475873304740024>

