


Exame n.º :835443

CPF :029.114.125-08
CNPJ :20.930.377/0001-57
Nascimento :14/05/1988
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2026

Paciente :Josuelo Pereira da Silva
Razão :LUIZ PAULO MURARO LTDA
Idade : 38 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE MAQUINAS

RG :/

Orelha Direita

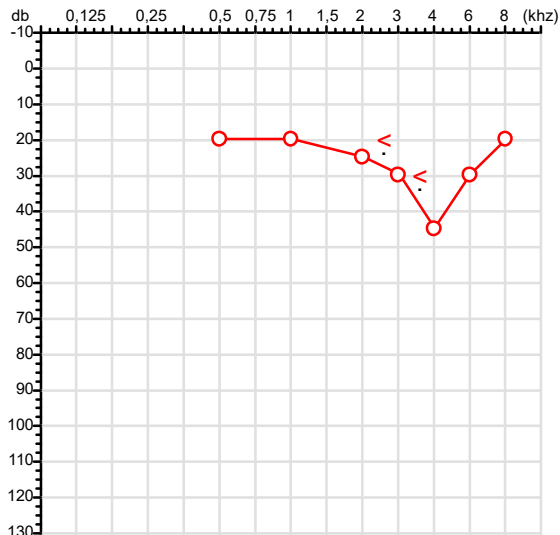

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	30	45	30	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	20	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	30	45	30	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :0E616F8D5AA08D1976A9357EC851EFAE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Josuelo Pereira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

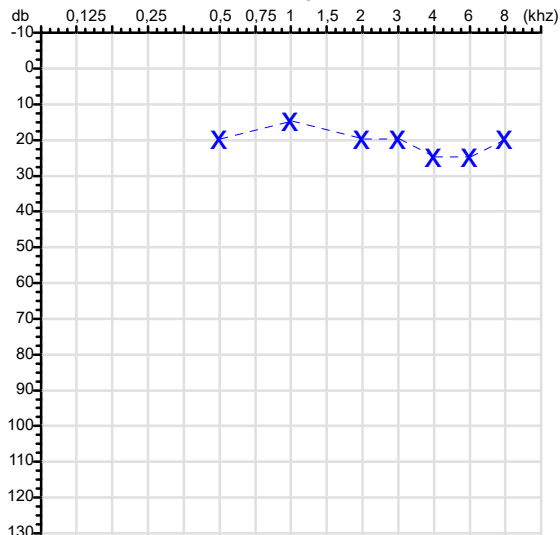

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 21/07/2026
Primeiro Nome: JOSUELO
Sobrenome: PEREIRA SILVA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 69.0

Data de nascimento: 14/05/1988
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: LUIZ PAULO MURARO
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 21/07/2026 08:53

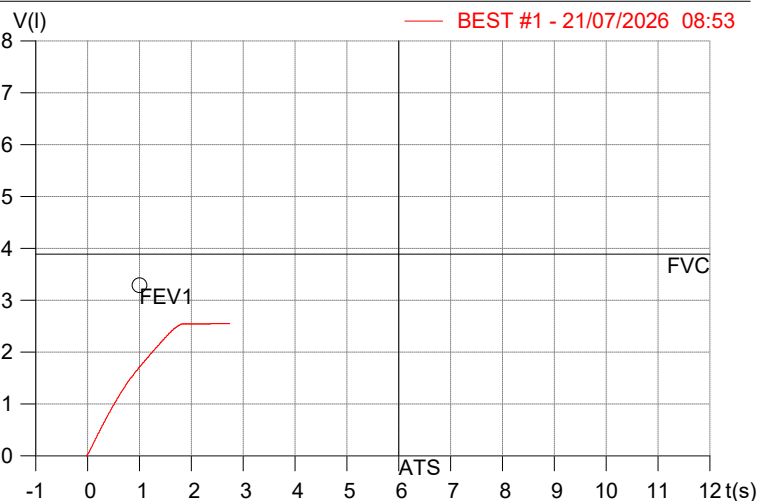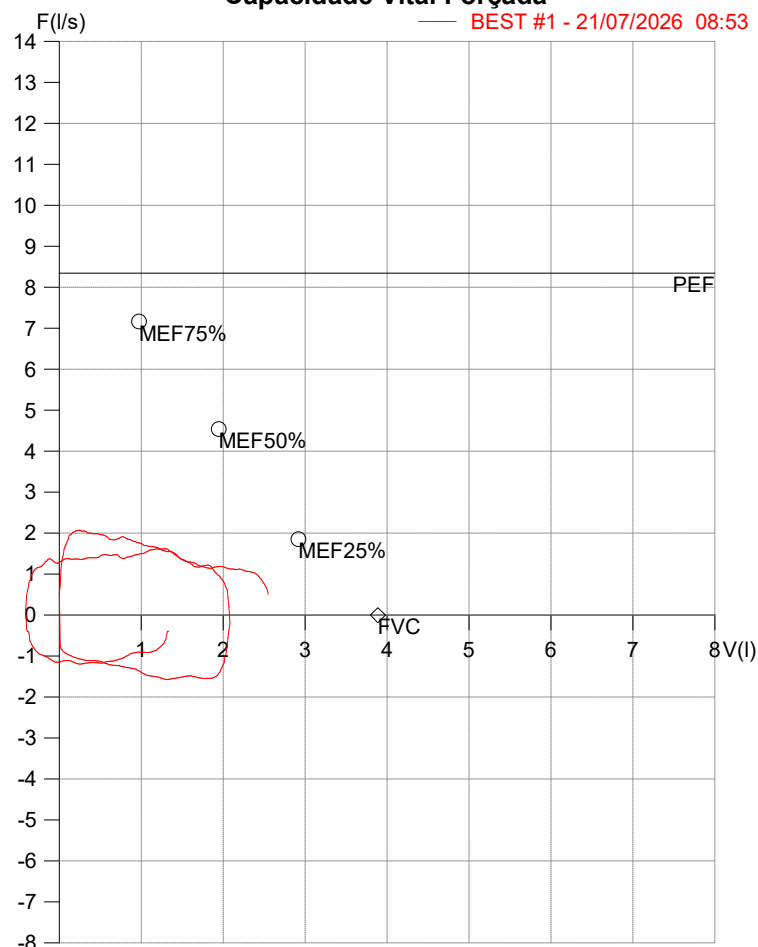

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.89	2.58	66.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.89	2.58	66.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.29	1.72	52.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.34	2.07	24.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.4	66.6	82.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.17	1.50	36.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.16	1.84	25.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.54	1.58	34.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.85	1.17	63.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	500.4	124.0	24.8

Diagnóstico:
Espirometria normal