

Exame n.º :836178


CPF :041.478.911-36
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :21/04/1991
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 24/07/2026

Paciente :Gessika Souza Franco
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 35 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :19968949/SSP-MT

Audiometria

Orelha Direita

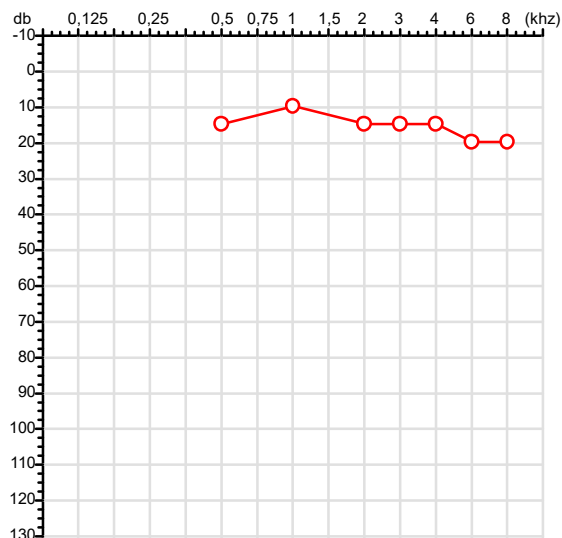

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

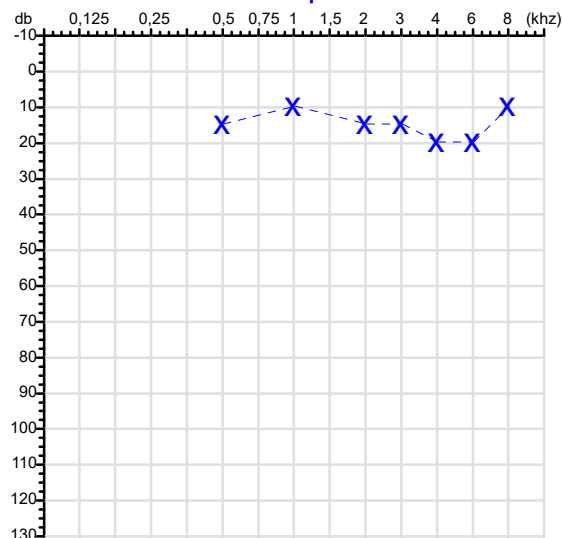

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0AE99F005E5896B02B0EEA9C8BC3064F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gessika Souza Franco

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 836178
Primeiro Nome: GESSIKA SOUZA
Sobrenome: FRANCO
Data: 24/07/2026

Data de nascimento: 21/04/1991
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 65.0
Altura (cm): 172.0

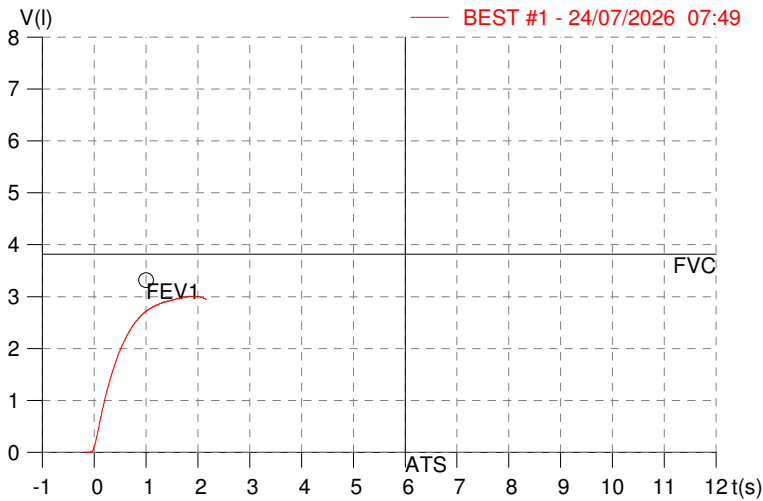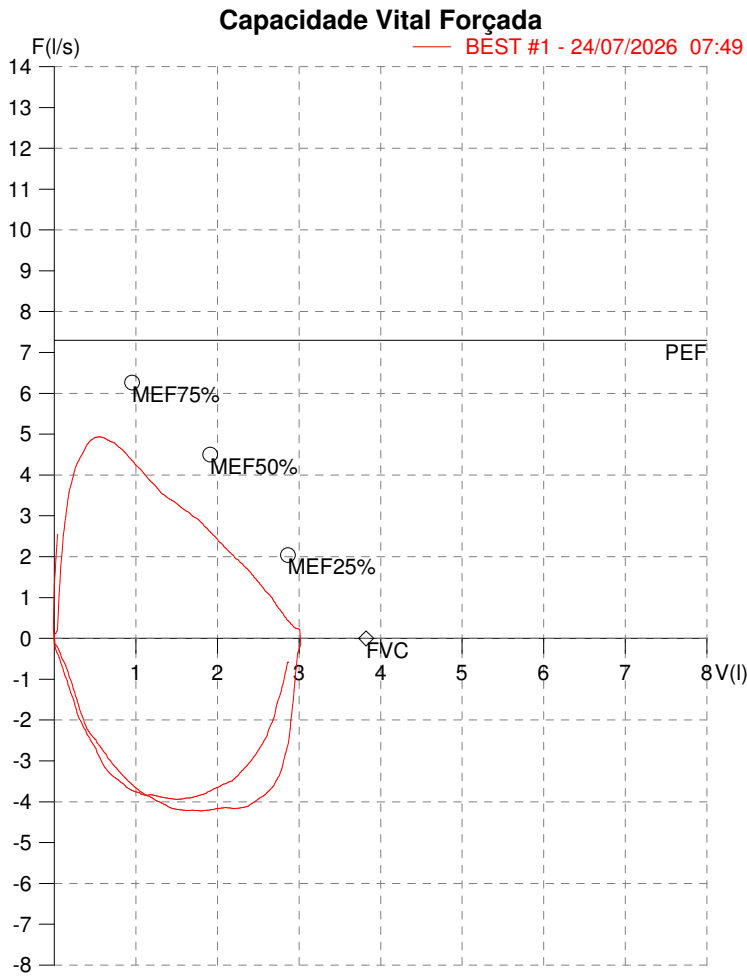

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.82	3.03	79.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.82	3.03	79.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.32	2.72	82.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.30	4.94	67.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.22	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.4	90.0	109.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.88	3.08	79.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.26	4.69	74.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.50	3.27	72.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.04	1.89	92.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	438.0	296.2	67.6

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada

Impresso 24/07/2026