



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000456 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : R O N.º 0 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098410

Funcionário

Nome : Otavio Soares Evaristo Setor: MEDIA FORCA - BOBINAGEM AT - MEDIA FORCA
CPF : 06216553178 Cargo: BOBINADOR V
RG : / Nascimento: 17/09/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 4 de agosto de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7


Autenticação Assinatura :9AFDBED0CBD6033B3AF82FA0F8220359
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :838093

CPF :062.165.531-78 Paciente :OTAVIO SOARES EVARISTO RG :/
 CNPJ :37.457.942/0004-56 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :17/09/2000 Idade : 25 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :MEDIA FORCA - BOBINAGEM AT - MEDIA FORCA
 Repouso :14h Função :BOBINADOR V
 Data do Exame : 04/08/2026

Audiometria

Orelha Direita

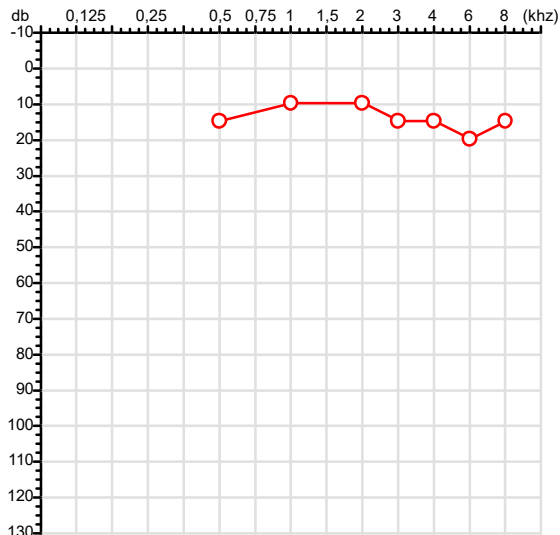

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

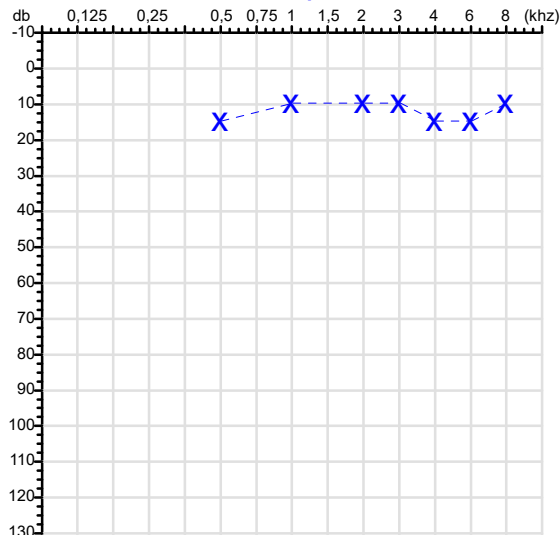

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FE6AE448DFDA019D9125E67D121F48FD
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Otávio Soares Evaristo


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838093
Primeiro Nome: OTAVIO SOARES
Sobrenome: EVARISTO
Data: 04/08/2026

Data de nascimento: 17/09/2000
Sexo: Macho
Peso (kg): 74.0
Altura (cm): 174.0

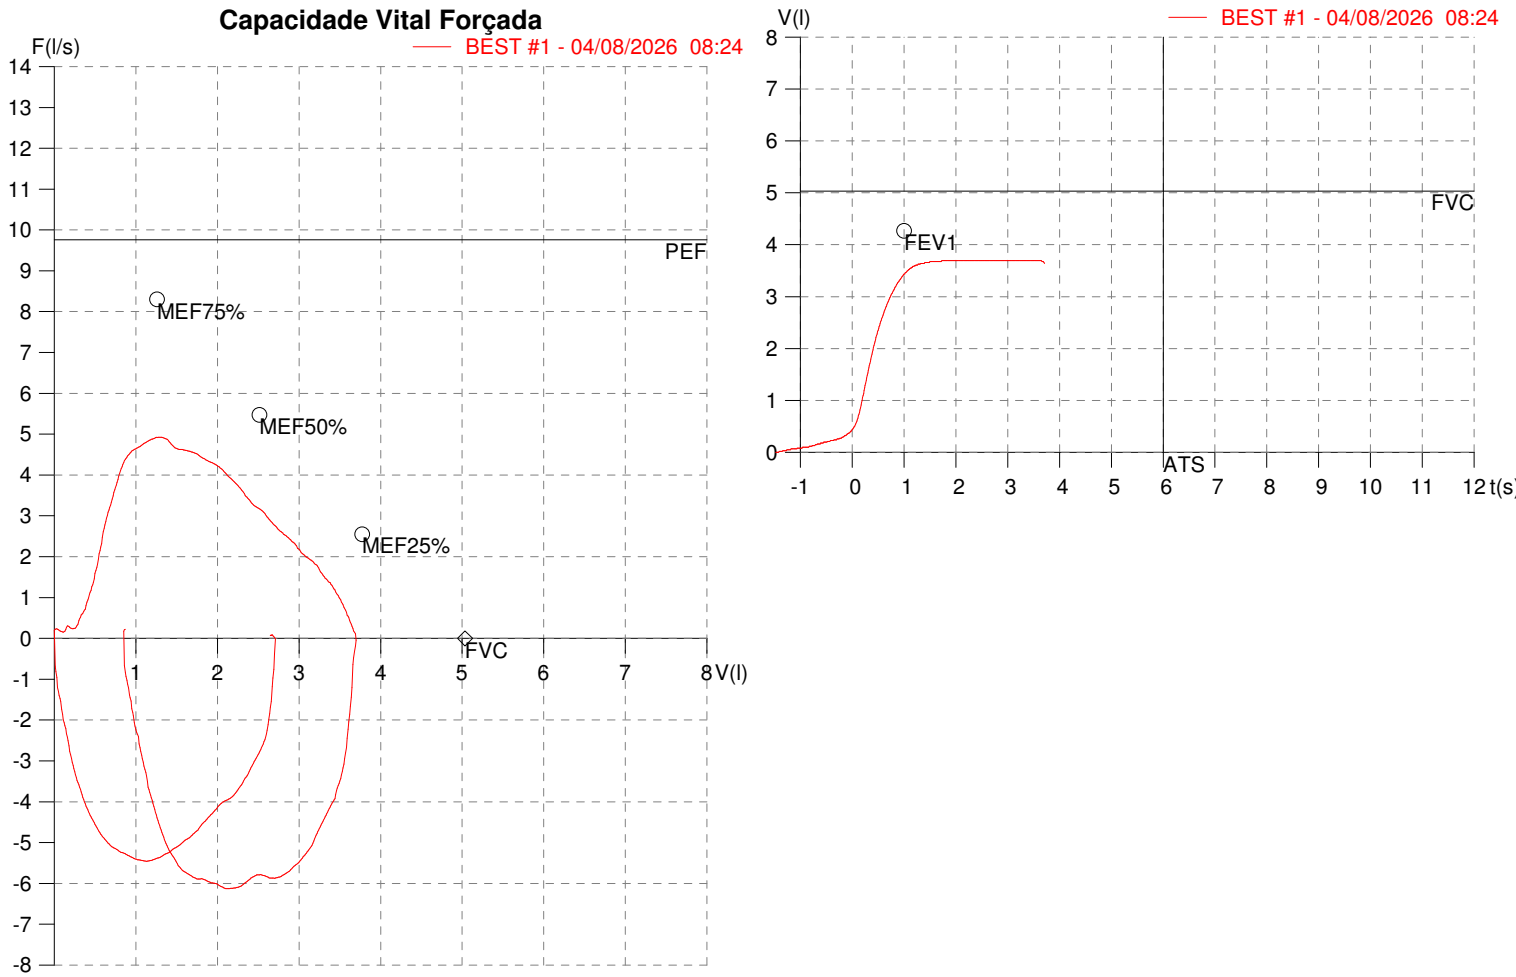

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.03	3.71	73.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.03	3.71	73.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.27	3.43	80.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.76	4.93	50.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.13	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.7	92.3	111.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.00	3.96	79.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.31	4.49	54.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.47	4.38	80.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.55	2.62	102.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	585.5	295.6	50.5

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADO

Impresso 04/08/2026