


Exame n.º :844258

CPF :037.571.923-70
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :14/11/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/09/2026

Paciente :Jose Francisco de Sousa Moraes
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 44 anos
Setor :ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

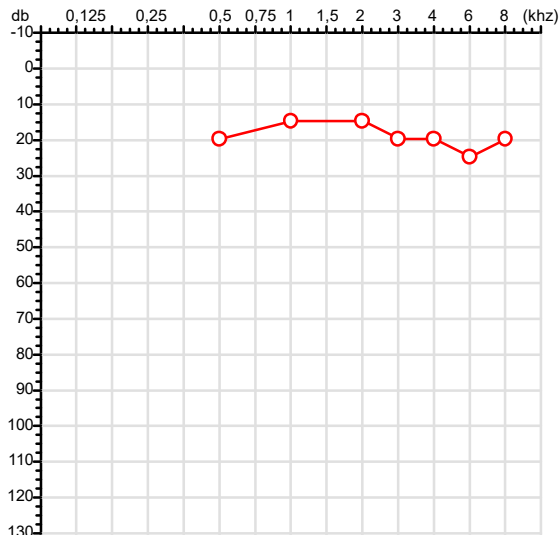

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

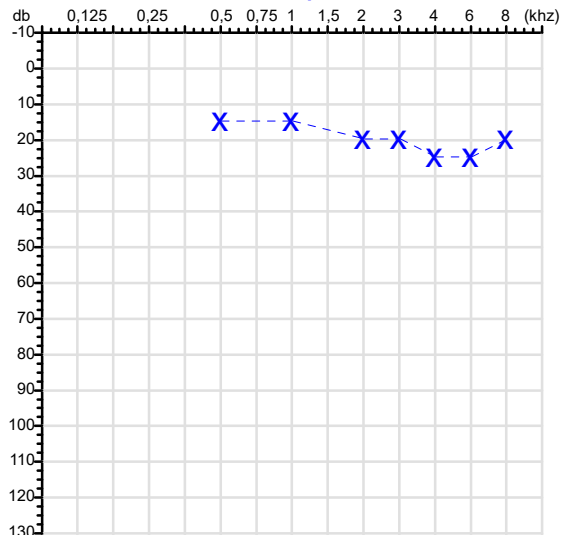

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :425D6E282EE8BF0803349D2CE7D86E76

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Francisco de Sousa Moraes

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	JOSE FRANCISCO DE SOUSA MORAIS		ID1	844258	Sexo	Masculino	Idade	44,8	Peso (kg)	103,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/11/1981	--	BMI (kg/m2)	35,6	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	2
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:10	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,02	4,24	95		
FEV1	L	3,40	3,44	99		
FEV1/FVC%	%	84,5	81,3	104		
FEV1/Vcmax%	%	84,5	81,3	104		

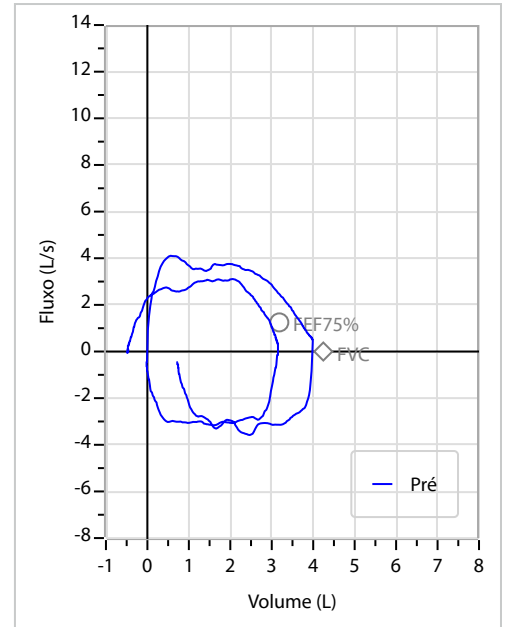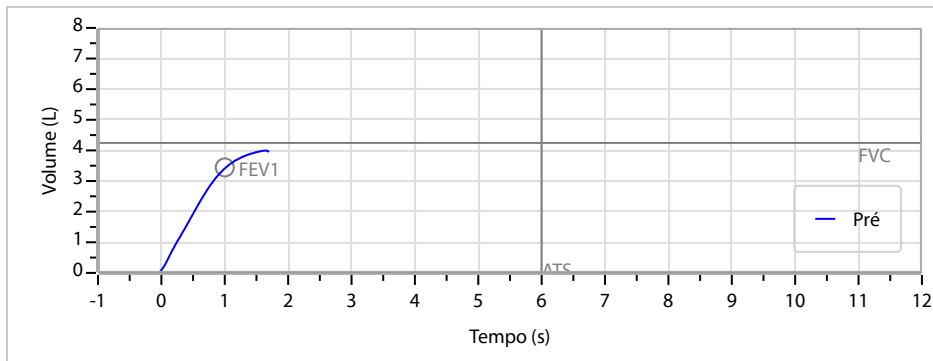

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,5% e um valor FVC de 4,02 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____