



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Romario Moreira da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 07309843541 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
RG : / Nascimento: 16/12/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de outubro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :9C662CFD5994FCCCC9124ACB979DACB6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :850398

CPF :073.098.435-41
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :16/12/1995
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/10/2026

Paciente :ROMARIO MOREIRA DA SILVA
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 30 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA

RG :/

Orelha Direita

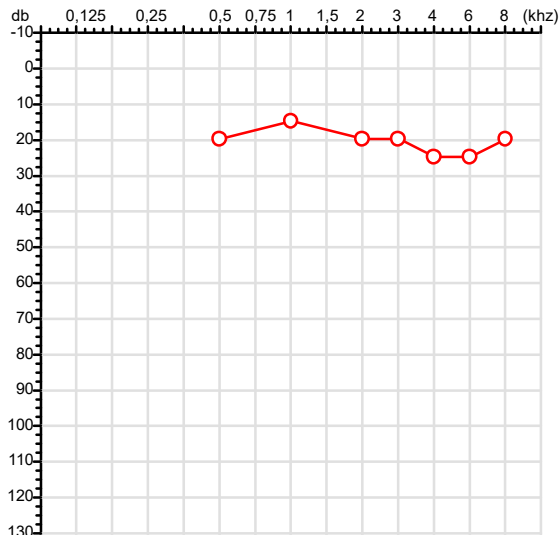

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

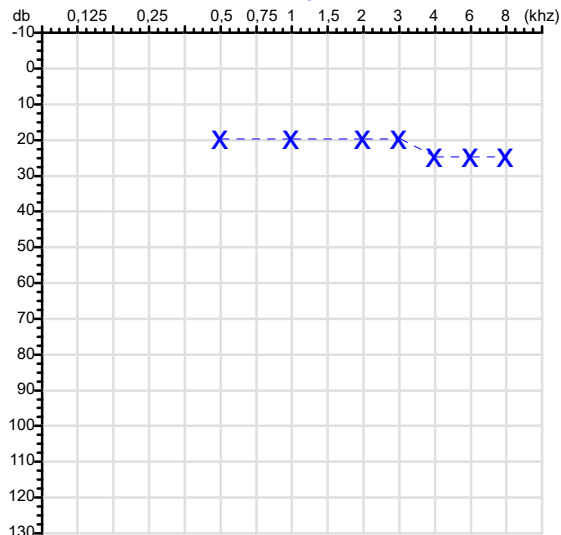

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DCF4551608CDCBE169928C929D67DC8A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Romario Moreira da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 850398
Primeiro Nome: ROMARIO MOREIRA
Sobrenome: DA SILVA
Data: 09/10/2026

Data de nascimento: 16/12/1995
Sexo: Macho
Peso (kg): 63.0
Altura (cm): 170.0

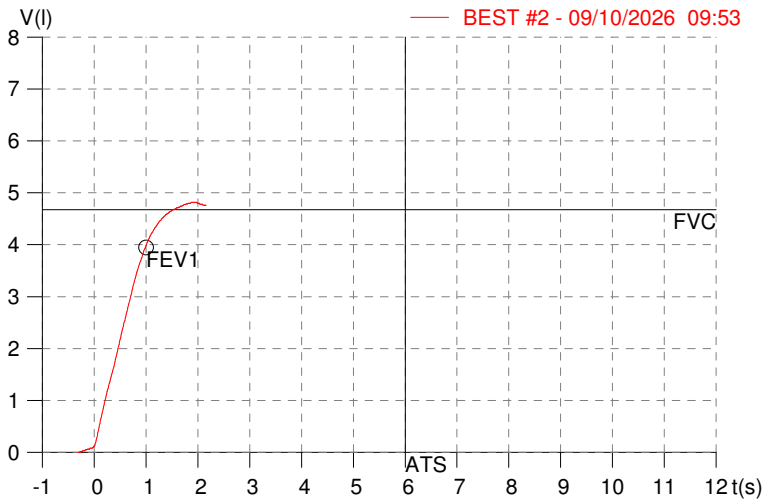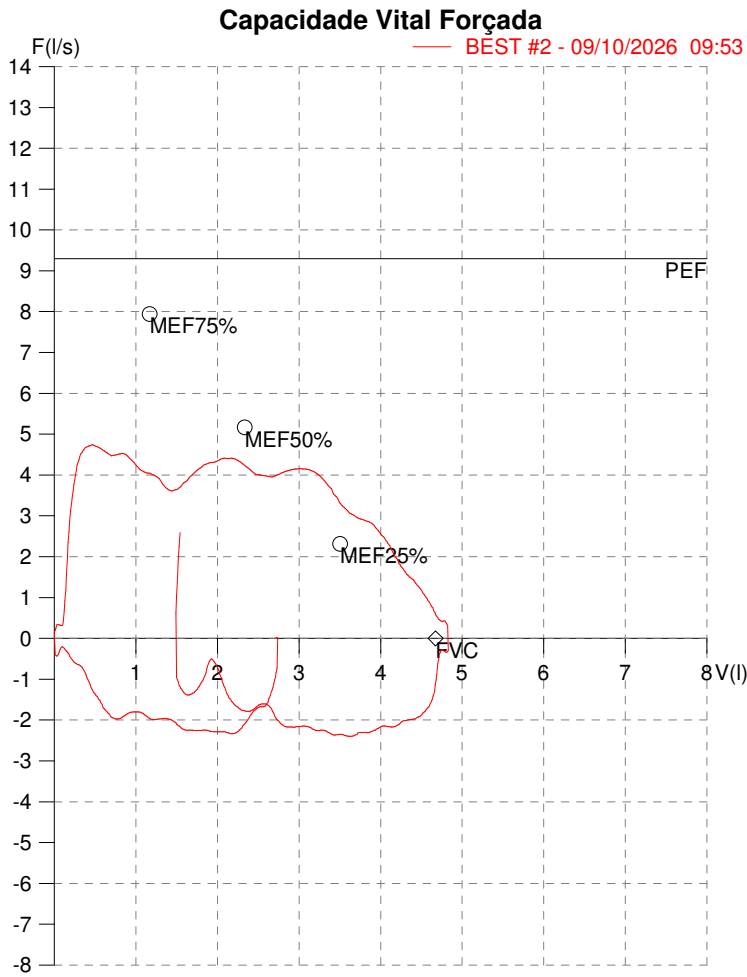

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#2	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.67	4.83	103.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.67	4.83	103.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.95	3.95	99.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.30	4.74	51.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.40	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	81.6	99.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.71	3.95	83.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.94	4.00	50.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.16	4.08	79.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.32	3.07	132.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	557.9	284.5	51.0

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 09/10/2026