



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 851184

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 10.866.985/0002-77

Fantasia : GMB IRRIGACAO

Razão Social : GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA

Endereço : AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS (LOT CENTRO) N.º 2736 Complemento : SALA 1

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.110-600

Funcionário

Nome : Regulo Rafael Ramirez Delgado

Setor: GERAL

CPF : 121.224.921-63

Cargo: AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG : /

Nascimento: 28/01/1974

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		ERGONÔMICO	PSICOSSOCIAL - COMPORTAMENTOS OFENSIVOS (ASSÉDIO - VIOLÊNCIA)
---	ERGONÔMICO	EXIGÊNCIA DE POSTURA INCÔMODA OU POUCO CONFORTÁVEL POR LONGOS PERÍODOS		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO		FÍSICO	RAIOS SOLARES
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	MECANICO/ACIDENTES	DIFERENÇA DE NÍVEL MENOR OU IGUAL A DOIS METROS		QUÍMICO	POEIRA MINERAL
---	QUÍMICO	METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA)		QUÍMICO	ACETONA (PROPANONA)
---	QUÍMICO	ACETATO DE ETILA			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	15/10/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	15/10/2026	EXAME CLINICO
1057	15/10/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 15 de outubro de 2026

Regulo Rafael Ramirez Delgado

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=851184>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 851184

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 10.866.985/0002-77

Fantasia : GMB IRRIGACAO

Razão Social : GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA

Endereço : AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS (LOT CENTRO) N.º 2736 Complemento : SALA 1

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.110-600

Funcionário

Nome : Regulo Rafael Ramirez Delgado

Setor: GERAL

CPF : 121.224.921-63

Cargo: AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG : /

Nascimento: 28/01/1974

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		ERGONÔMICO	PSICOSSOCIAL - COMPORTAMENTOS OFENSIVOS (ASSÉDIO - VIOLÊNCIA)
---	ERGONÔMICO	EXIGÊNCIA DE POSTURA INCÔMODA OU POUCO CONFORTÁVEL POR LONGOS PERÍODOS		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO		FISICO	RAIOS SOLARES
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	MECANICO/ACIDENTES	DIFERENÇA DE NÍVEL MENOR OU IGUAL A DOIS METROS		QUIMICO	POEIRA MINERAL
---	QUIMICO	METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA)		QUIMICO	ACETONA (PROPANONA)
---	QUIMICO	ACETATO DE ETILA			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	15/10/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	15/10/2026	EXAME CLINICO
1057	15/10/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 15 de outubro de 2026



Regulo Rafael Ramirez Delgado

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=851184>




Exame n.º :851184

CPF :121.224.921-63
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :28/01/1974
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 15/10/2026

Paciente :Regulo Rafael Ramirez Delgado
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 52 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

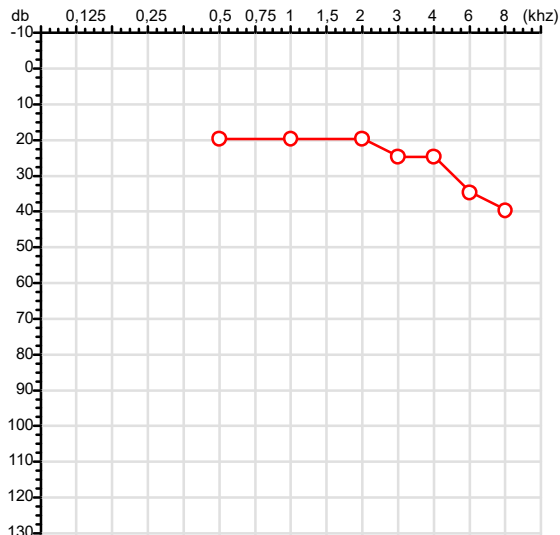

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolay C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra
CRM-MT 17341


Assinatura eletrônica :E233E96AB91B1D6290672F6FB9C61AB5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Regulo Rafael Ramirez Delgado
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

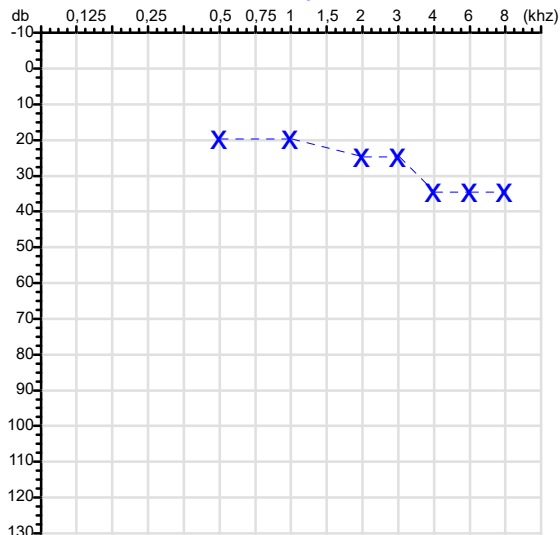

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	35	35

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	35	32

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 15/10/2026
Primeiro Nome: REGULO RAFAEL
Sobrenome: RAMIREZ DELGADO
Altura (cm): 170.0
Peso (kg): 80.0

Data de nascimento: 28/01/1974
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Sim(7/3)

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 15/10/2026 08:33

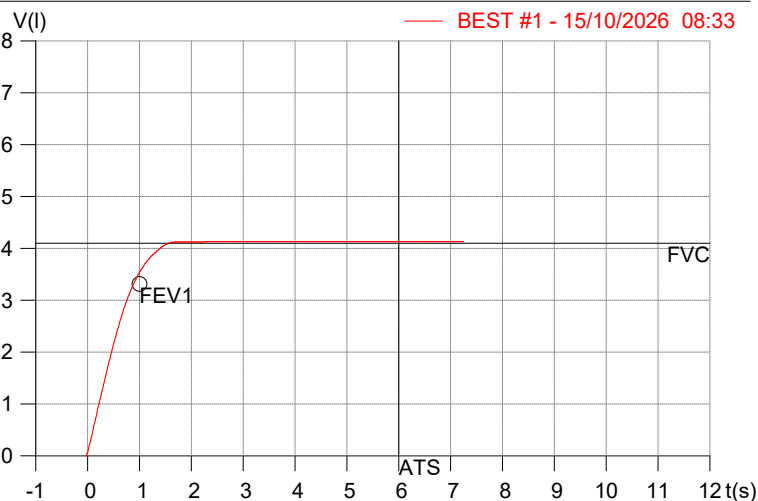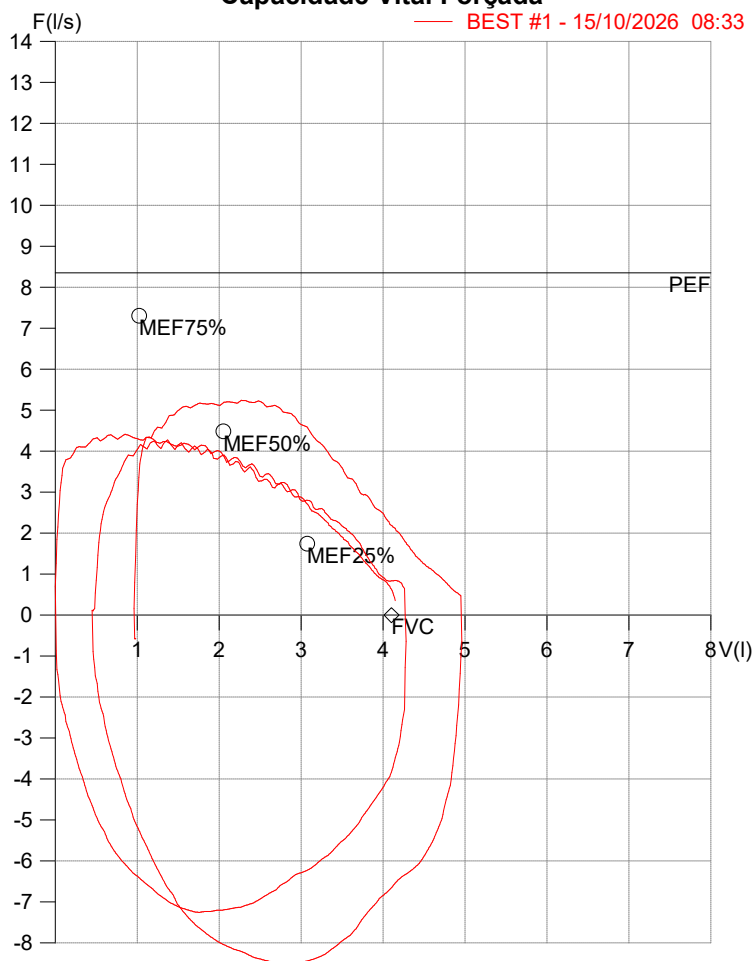

Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEF _r	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.10	4.18	101.9
4.10	4.18	101.9
3.31	3.55	107.1
8.35	4.41	52.8
77.8	84.9	109.1
3.76	3.67	97.6
7.30	4.28	58.5
4.48	3.73	83.2
1.75	2.59	148.5
	2.3	
501.1	264.8	52.8

Diagnóstico:
Espirometria normal