

Exame n.º :851622


CPF :008.017.701-81
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :22/08/1961
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 19/10/2026

Paciente :FABRICIANO SILVA
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA
Idade : 65 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

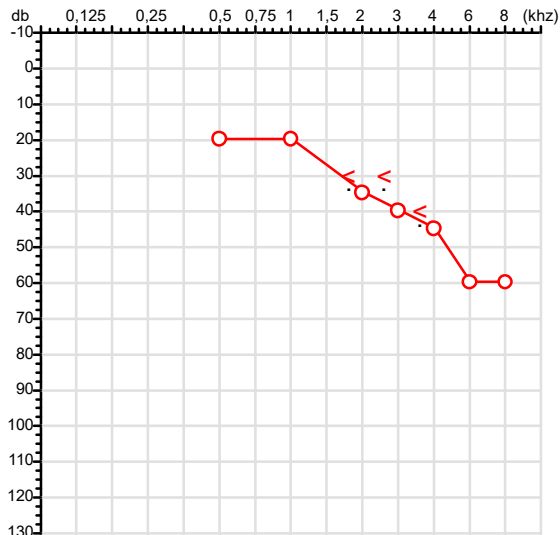

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	40	45	60	60

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	30	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	40	45	60	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

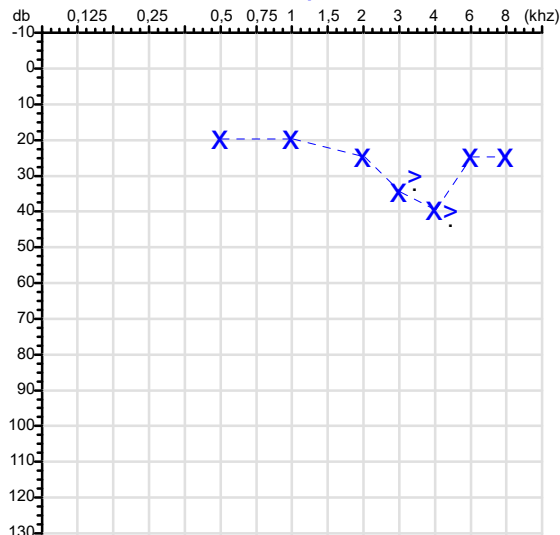

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	25	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :86D665A088929DEE6878036A281F591D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Fabriciano Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	FABRICIANO SILVA		ID1	851622	Sexo	Masculino	Idade	65,1	Peso (kg)	55,00	Altura (cm)	163,0
Agrupamento	--	D.O.B.	22/08/1961	--	BMI (kg/m2)	20,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	07:38	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,72	3,31	82		
FEV1	L	2,61	2,61	100		
FEV1/FVC%	%	95,9	78,6	122		
FEV1/Vcmax%	%	95,9	78,6	122		

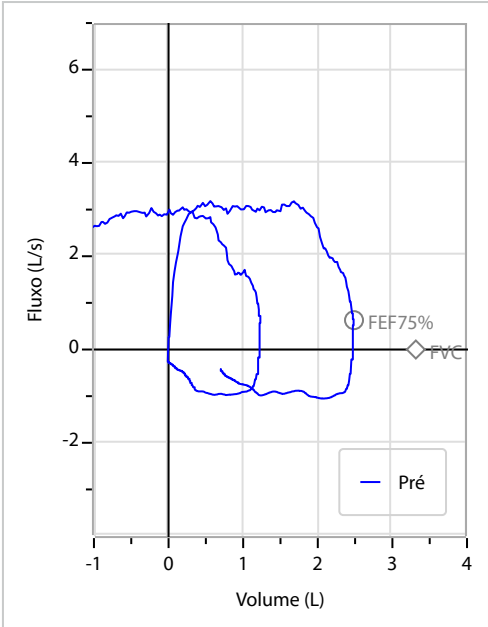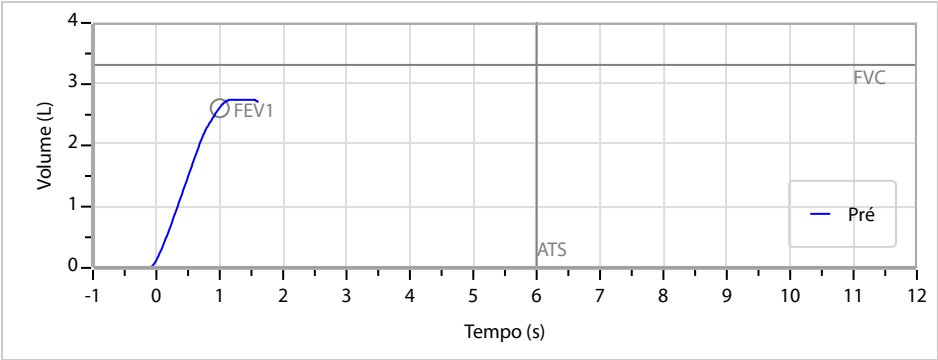

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,9% e um valor FVC de 2,72 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____